


**INFORMATION – LABORATOIRE  
SERVICE DE MICROBIOLOGIE  
(2014-09-09)**

Aux chefs des unités de soins de courte et longue durée,

**Objet : Remplacement des flacons FAN (bouteilles d'hémoculture)**

Madame, Monsieur,

Nous aimerions vous informer que les flacons FAN à base de charbon activé ont été remplacés par les flacons FAN Plus utilisant la technologie brevetée des billes polymériques adsorbantes (voir images ci-dessous).

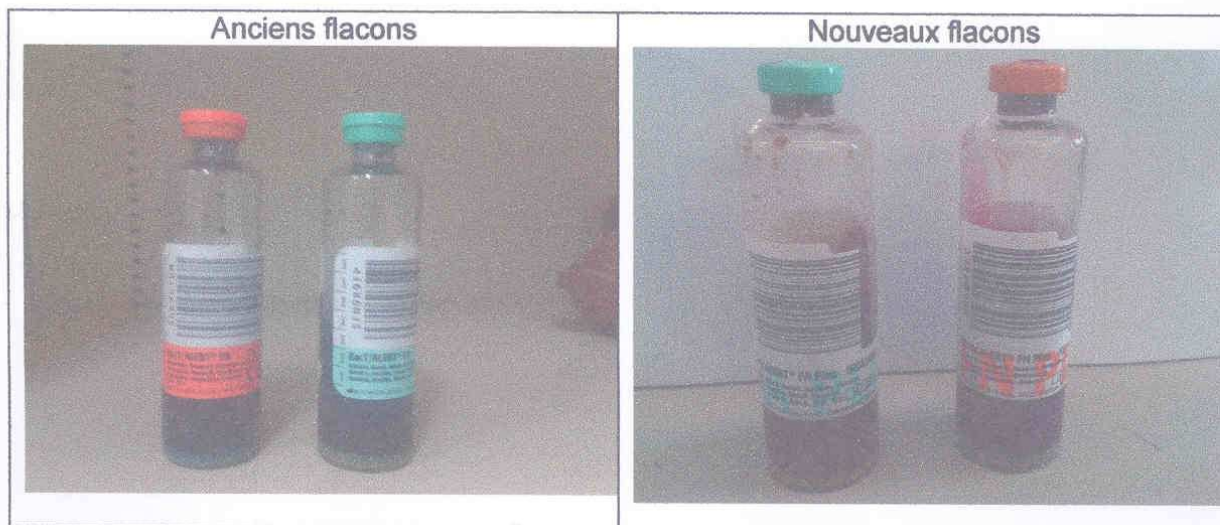

La table des abréviations a été corrigée dans la section « Introduction » du répertoire des analyses de laboratoire. Cependant, les numéros de produits demeurent les mêmes :

Bact/Alert FA Plus (30 ml) (vert)	3030032
Bact/Alert FN Plus (40 ml) (orange)	3030033

Les anciens flacons seront acceptés jusqu'à l'épuisement de votre inventaire.

Nous vous remercions de votre collaboration.

  
Anne Vibien, md  
Chef du service clinique de microbiologie

  
Josée Fournier  
Directrice des services généraux